



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSILIPON**

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"*

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa,8) -80122- Napoli

Verbale n.5 del 30.6.2023

Oggetto: R.D.O. N. 3540238 PER LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, IN ACQUISTO DI N. 1 FACOVITRECTOMO COMPRESIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER ALMENO 24 MESI E MATERIALE DI CONSUMO PER 36 MESI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OCULISTICA DEL P.O. SANTOBONO - VALORE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA EURO 150.000,00, OLTRE IVA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - PROGETTO DI PREVENZIONE DELL'IPOVISIONE INFANTILE COD PROGETTO WBS H00067

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 8:35, sono presenti presso la sede amministrativa dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, sita in Napoli alla Via Ravaschieri (già Via della Croce Rossa, 8), in seduta telematica sulla piattaforma AcquistinretePA, i componenti della Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 23.5.2023, che risulta così costituita:

PRESIDENTE: Dott. Massimo Notaro – Dirigente medico in servizio c/o U.O.C. Oculistica del P.O. Santobono;

COMPONENTE: Dott.ssa Ida Cesarano– Dirigente medico in servizio c/o U.O.C. Oculistica del P.O. Santobono;

COMPONENTE: Dott.ssa Agnese Santarpia– Dirigente medico in servizio c/o U.O.C. Oculistica del P.O. Santobono;

SEGRETARIO: Dott. Riccardo Savastano – Coll. Amm. in servizio c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

Premesso:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 21.4.2023 è stata indetta una procedura di gara sotto soglia comunitaria per la fornitura con posa in opera di nr. 1 facovitrectomo comprensiva di assistenza e manutenzione full risk per almeno 24 mesi e materiale di consumo per n. 36 mesi, finanziata nell'ambito del progetto di prevenzione dell'ipovisione infantile, con fondi della Regione Campania di cui al D.G.R.C. 626 del 29.11.2022 e successivo Decreto di liquidazione n. 525 del 22.12.2022 per le esigenze della UOC Oculistica da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 150|000,00 oltre Iva;

- che, pertanto, in data 24.4.2023, è stata inoltrata a mezzo Me.P.A. la R.D.O. n.3540238, aperta a tutti gli Operatori economici abilitati alla presentazione delle offerte per la categoria merceologica dei prodotti oggetto di richiesta, con termine ultimo di presentazione delle offerte previsto entro le ore 12:00 del 11.5.2023;
- che, entro il termine previsto, sono pervenute le offerte degli Operatori di seguito indicati, unitamente agli estremi di ricezione, così come desunti dalla piattaforma Me.P.A.:

Operatore economico	Estremi di ricezione
1. TEC MED S.R.L.	10/05/2023 12:51:25
2. MEDINOVA S.R.L.	11/05/2023 10:13:30

Visto il verbale n. 1 del 30.5.2023 del Seggio di gara, agli atti, nonché pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Bandi di gara e contratti", dal quale risulta l'ammissione dell'Operatore economico Tec med S.r.l. e l'ammissione con riserva dell'Operatore economico Medinova S.r.l. per le motivazioni tutte riportate nel citato verbale.

Visto il verbale n. 2 del 6.6.2023 del Seggio di gara, agli atti, nonché pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Bandi di gara e contratti", dal quale risulta l'ammissione alla successiva fase di gara anche dell'Operatore economico Medinova S.r.l. in quanto ha regolarizzato la documentazione amministrativa richiesta, a seguito dell'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Visto il verbale n. 3 del 8.6.2023 della Commissione di gara, dal quale risulta l'apertura sulla piattaforma telematica delle buste contenenti le offerte tecniche digitali, la cui documentazione è stata acquisita dalla Commissione su supporto informatico ed assunta in custodia dal Presidente, per l'esame in seduta riservata della conformità al capitolato tecnico dei prodotti offerti e l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Visto il verbale n. 4 del 22.6.2023, agli atti nonché pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Bandi di gara e contratti", dal quale risulta che la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione del lotto in oggetto, come di seguito indicato:

Lotto unico: Fornitura con posa in opera di n. 1 facovitrectomo comprensivo di assistenza e manutenzione full risk per almeno n. 24 mesi e materiale di consumo per n. 36 mesi all' Operatore economico Medinova S.r.l., che ha presentato l'unica offerta conforme ed inferiore alla base di gara – spesa complessiva Euro 122.402,00 oltre Iva.

Tanto premesso, la Commissione di gara prende atto dell'istanza di riammissione trasmessa dall'Operatore economico Tec Med S.r.l., trasmessa a mezzo MEPA in data 23.06.2023, agli atti di gara.

In merito la Commissione, rileva quanto segue:

Con verbale n. 4 del 22.06.2023, la Commissione di gara ha disposto l'esclusione dalla procedura di gara dell'O.E. Tecmed S.r.l. in quanto "il capitolato tecnico prevede a pena di esclusione la fornitura di tutto quanto occorrerà (tubi, raccordi innesti) per il collegamento ad impianto centralizzato di aspirazione. La Ditta Tec med dichiara di non fornire tali materiali..."



A seguito della comunicazione di esclusione ex art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 è stato notificato, a mezzo MEPA dal RUP, alla ditta Tec med l'esclusione disposta dalla Commissione di gara.

Successivamente la ditta TEC med, in riscontro alla predetta nota, ha inviato in data 23.6.2023 istanza di riammissione in quanto, a parere della stessa, non risulta univoco dagli atti di gara che tale materiale debba essere fornito a pena di esclusione ed, inoltre, la Ditta tec Med ha dichiarato di non fornire il materiale (tubi, raccordi ed innesti) perché interpretato come materiale aggiuntivo per la fornitura con posa in opera dell'apparecchiatura richiesta.

In ogni caso la Ditta Tec med ha rappresentato che all'interno dell'offerta tecnica è chiaramente riportato: *"la fornitura con posa in opera è comprensiva di tutto quanto necessario (tubi, raccordi ed innesti) per il regolare e normale utilizzo dell'apparecchiatura"*.

La Commissione di gara, accertata la presenza all'interno dell'offerta tecnica di quanto dichiarato dalla Ditta in relazione alla fornitura di tutto il materiale necessario per il corretto e regolare funzionamento dell'apparecchiatura e dunque la conformità dell'offerta al capitolato tecnico, accoglie la richiesta di Tec med e per l'effetto annulla in autotutela l'esclusione disposta con verbale n. 4 del 22.06.2023 e riammette la predetta Ditta alla procedura di gara, ritenendo che l'offerta tecnica – rispetto ad un profilo dubbio - vada comunque interpretata secondo il principio del *favor participationis*.

Si rileva, infatti, come da costante e recente giurisprudenza la stazione appaltante può attivare il soccorso procedimentale *"per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità"* (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 22.5.2023, n. 318).

In altri termini, nel caso in cui l'offerta tecnica o economica siano caratterizzate da profili di non intellegibilità (ossia ove il contenuto dell'offerta de qua sia caratterizzato da carenza o incertezza assoluta nei suoi elementi essenziali), si potrà attivare il soccorso procedimentale al fine di correggere *"gli errori materiali inficianti l'offerta, a condizione che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto"* (così Cons. St., Sez. V, 9.1.2023, n. 290).

Pertanto, la Commissione, procede alla valutazione dell'offerta tecnica della Ditta Tec Med secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

All'esito della stessa, la Commissione approva nuovamente la valutazione delle offerte tecniche del lotto rubricato: *"Fornitura con posa in opera di n. 1 facovitrectomo comprensivo di assistenza e manutenzione full risk per almeno n. 24 mesi e materiale di consumo per almeno 36 mesi"* con l'attribuzione dei punteggi di qualità, con le modalità indicate nel disciplinare di gara per la procedura di gara di cui alla R.D.O. n. 3540238, come da parere tecnico e schede di valutazione allegate al presente verbale, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, che annullano e sostituiscono integralmente quelle allegate al verbale n. 4 del 22.06.2023.



La Commissione di gara procede quindi, in seduta riservata e telematica, all'inserimento sulla piattaforma M.e.P.A. dei punteggi di qualità attribuiti alle offerte tecniche degli Operatori economici giudicati conformi al capitolato tecnico, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

Fornitura con posa in opera di n. 1 facovitrectomo comprensivo di assistenza e manutenzione full risk per almeno n. 24 mesi e materiale di consumo per almeno 36 mesi

Operatore economico	Punteggio qualità
1. Medinova S.r.l.	60,24
2. Tec med S.r.l.	80,00

Successivamente, in seduta pubblica e telematica, su piattaforma M.e.P.A., la Commissione di gara alle ore 10:00 procede all'apertura anche della busta telematica contenente l'offerta economica dell'Operatore economico Tec med S.r.l., constatando la conformità della stessa a quanto previsto dal disciplinare di gara. Conseguentemente procede, alla lettura dell'offerta economica e del relativo dettaglio economico, le cui risultanze, sono di seguito indicate:


Fornitura con posa in opera di n. 1 facovitrectomo comprensivo di assistenza e manutenzione full risk per almeno n. 24 mesi e materiale di consumo per almeno 36 mesi

Operatore economico	Prezzo offerto	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1. Medinova S.r.l.	€ 122.402,00	60,24	18,12	78,36
2. Tec med S.r.l.	€ 119.545,00	80,00	20	100


La Commissione, pertanto, redige la graduatoria finale relativa alla fornitura con posa in opera di n. 1 facovitrectomo comprensiva di assistenza e manutenzione full risk per almeno 24 mesi e materiale di consumo per n. 36 mesi all'Operatore economico, che annulla e sostituisce la graduatoria approvata con il verbale n. 4 e annulla altresì la proposta di aggiudicazione di cui al predetto verbale.

Preso, infine, atto che non ricorrono i presupposti previsti all'art. 97 comma 3 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., propone l'aggiudicazione all'Operatore economico Tec - med. La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza. La seduta termina alle ore 10:20. Del che è verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente

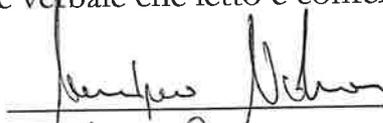

I Componenti





Il Segretario



RELAZIONE TECNICA
VALUTAZIONE TEC- MED

In riferimento al punto 1 "Monitor (dimensioni, risoluzione, movimentazioni, sensore luce ambiente, etc)"

- ✓ la ditta TECMED propone un sistema con monitor:
- LCD Touch Screen 19"
- Tecnologia: analogica resistiva
- Display a cristalli liquidi, schermo piatto (TFT LCD), gamma colori completa
- Pixel: 1280 x 1024
- Regolazione fisica: Inclinazione: +15° verso l'alto e -10° verso il basso, Rotazione: 90° verso sinistra e 90° verso destra
- Luminosità: controllo tramite schermo a sfioramento
- Resistenza chimica alle soluzioni detergenti
- Lunetta antigocciolamento.
- Oltre al controllo automatico in funzione della luce ambientale e la possibilità di regolazione manuale della luminosità del monitor, il colore dello sfondo è automaticamente diversificato tra funzionalità del segmento anteriore (chiaro) e del segmento posteriore (scuro), per l'immediato ed intuitivo riconoscimento del momento chirurgico selezionato e per ridurre l'impatto luminoso durante le fasi di chirurgia vitreoretinica.

Si esprime per tanto un giudizio buono

In riferimento al punto 2 "Caratteristiche facoframmentazione (es. frequenza manipolo, etc)"

- ✓ la ditta TECMED propone:
- Manipolo U/S piezoelettrico a bassa frequenza con elongazione longitudinale per tutte le tecniche chirurgiche di facoemulsificazione Standard e Microincisionali
- Frequenza di lavoro: 28,5kHz
- N° Ceramiche piezoelettriche: 6
- Controllo automatico dell'elongazione
- Chip per diagnosi funzionalità/usura
- Connessione irrigazione "Surelock"
- Lunghezza (senza cavo): 147 mm
- Peso (senza cavo): 66 gr
- Materiale guscio: Titanio
- Punta U/S-Faco per incisioni da 1.2mm a 3.2mm - Punta U/S-Faco per incisioni da 1.8mm a 2.5mm angolate (Kelman) - Punta U/S-Facoframmentazione via pars plana 20G e 23G. Il profilo della punta fornisce una superficie omogenea, senza soluzione di continuità tra ago e sleeve, rendendone estremamente agevole l'inserimento attraverso le microincisioni tipiche delle più diffuse tecniche

Si esprime per tanto un giudizio ottimo




3. In riferimento al punto 3 "Caratteristiche vitrectomia (velocità, tipo vitrectomo, modalità di funzionamento)"

- ✓ la ditta TECMED propone:
 - Vitrectomo doppio taglio con linee di attuazione e di aspirazione - 1x
 - Azionamento pneumatico
 - Tecnologia Bi-Blade™ a doppio taglio per ciclo
 - Sensore tattile posizione porta di aspirazione
 - Dimensioni (stelo): 32,84 mm x 0,6 mm (23G)
 - Frequenza di lavoro: da 30 a 7.500 cicli al minuto
 - Cicli di taglio applicabili: 1 - 7500 cicli/min.
 - Frequenza di taglio: da 60 a 15.000 tpm ("bi-Blade™") / da 30 a 7.500 tpm (standard)
 - Vuoto: da 0 a 660mmHg con incrementi di 1mmHg
 - Peso (senza tubi): 4,89 g
 - Lunghezza tubi: 180 cm
 - Per tutte le modalità: controllo lineare del vuoto con servo-valvola di controllo dell'aspirazione e trasduttore del vuoto gestiti da un circuito di controllo ad Algoritmo PID, da 0 mmHg a 660 mmHg con salita regolabile in steps di 1mmHg, con impostazione Lineare Standard / Lineare Front Loaded / Lineare Back Loaded / Lineare Inversa (Co-Lineare).
 - Taglio lineare: da 60 a 15.000 tagli al minuto con 23G, 25G e 27G "bi-Blade™" (da 30 a 7.500 con vitrectomi Standard) con incrementi di 1 tpm.
 - Controllo: controllo lineare della velocità di taglio e del vuoto tramite i movimenti verticale e laterale esterno del pedale (doppio controllo lineare simultaneo indipendente Vuoto/Taglio).
 - Taglio Co-lineare: da 60 a 15.000 tagli al minuto con 23G, 25G e 27G "bi-Blade™" (da 30 a 7.500 con vitrectomi Standard) con incrementi di 1 tpm.
 - Controllo: controllo lineare della velocità di taglio e del vuoto tramite il movimento verticale del pedale (controllo singolo lineare proporzionale inverso Vuoto/Taglio).
 - Taglio fisso: da 60 a 15.000 tagli al minuto con 23G, 25G e 27G "bi-Blade™" (da 30 a 7.500 con vitrectomi Standard) con incrementi di 1 tpm.
 - Controllo: ON/OFF con movimento laterale esterno del pedale.
 - Taglio singolo: 1 ciclo di taglio singolo "on demand"
 - Controllo: attivazione di un singolo taglio al 95% del movimento laterale esterno del pedale.

Si esprime per tanto un giudizio ottimo

4. In riferimento al punto 4 "Endoilluminazione (caratteristiche sorgenti, regolazione luminosità etc)"

- ✓ la ditta TECMED propone
 - Filtro di base 435nm (il contenuto spettrale della luce trasmessa al paziente è compreso tra 435 nm e 650 nm)
 - Intervallo di controllo: 0-100%, risoluzione 1%
 - Doppia sorgente di illuminazione con filtri supplementari brevettati - ambra, verde e giallo - inseribili da pedale o da monitor, che permettono una visualizzazione

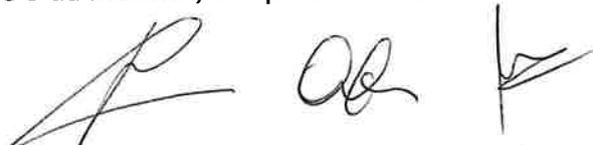

differenziata dei tessuti, filtrando la luce blu , utilizzabili come coadiuvanti o in alternativa ai coloranti intraoculari

Si esprime per tanto un giudizio discreto


5. In riferimento al punto 5 “Modulo diatermia”

- ✓ la ditta TECMED propone
 - Modulo per diatermia bipolare, compatibile con un’ampia gamma di pinze e matite bipolari, sia riusabili che monouso.
 - Gamma in uscita: 7,5 Watt nominali a 100 Ohm
 - Frequenza: 1 MHz nominale
 - Tensione di picco massimo a circuito aperto = 120 V
 - Programmabile da 0% a 100% con incrementi dell’1%
 - Coagulazione fissa
 - Coagulazione lineare

Si esprime per tanto un giudizio buono

6. In riferimento al punto 6 “Modulo pompa”

- ✓ la ditta TECMED propone
 - una Pompa di Aspirazione Venturi a controllo di vuoto, concepita per fornire, se necessario, un controllo fluidico ibrido. Il controllo del vuoto EQ Fluidic™ fornito dal sistema consente di lavorare in modalità Venturi o replicare l’effetto peristaltico, agendo direttamente sul flusso in aspirazione in base alla velocità di risposta della pompa.
 - Vuoto massimo: 660mmHg.
 - Rilevamento continuo del fluido aspirato
 - Rilevamento di Cassetta quasi piena/Cassetta piena
 - Curve di risposta vuoto personalizzabili
 - Tempo di risposta vuoto programmabile su 5 livelli
 - Vuoto I/A - Estrusione: da 0 a 660 mmHg
 - Vuoto Facoemulsificazione: da 10 a 660 mmHg
 - Vuoto Facoframmentazione: da 10 a 660 mmHg
 - Vuoto Vitrectomia: da 0 a 660 mmHg
 - Controllo del vuoto: incrementi di 1 mmHg
 - Il controllo del vuoto EQ Fluidic™ fornito dal sistema consente la totale personalizzazione della fluidica in funzione delle esigenze dell’operatore e delle tecniche chirurgiche adottate, agendo direttamente sul flusso in aspirazione in base alla velocità di

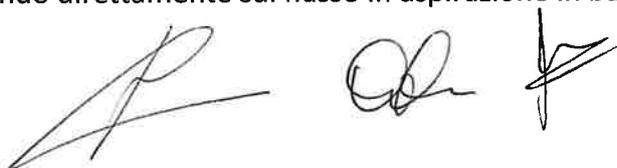

risposta della pompa ed alla possibilità di programmare l'aspirazione, nelle fasi di facoemulsificazione, in Modalità ACF (Advanced Control Flow). Il sistema elettronico di riconoscimento del livello fluidico fornisce la quantità di fluido aspirato dall'occhio, permettendo di impostare la risposta di lavoro della pompa sulla base delle specifiche esigenze chirurgiche.

Si esprime per tanto un giudizio ottimo

7. In riferimento al punto 7 "Modulo fluidi e scambio aria fluidi"

- ✓ la ditta TECMED propone
 - La funzione di Controllo fluidi viscosi consente di generare le pressioni di iniezione e le condizioni di vuoto necessarie per l'iniezione nell'occhio e l'aspirazione dall'occhio di fluidi viscosi. Fornisce fino a 70 psig (500 kPa / 5,0 bar) con incrementi di 5 psi di pressione pneumatica al sistema di tubi monouso. Tutte le altre funzioni del sistema per il segmento posteriore a eccezione della frammentazione e della vitrectomia possono essere usate simultaneamente o insieme a questa funzione
 - Modalità Operative
 - Iniezione fissa / Iniezione lineare
 - Doppio lineare: Iniezione lineare/Vuoto lineare
 - Estrazione fissa / Estrazione lineare
 - INFUSIONE ARIA - SCAMBIO ARIA/FLUIDI
 - La funzione Scambio aria/fluido fornisce un flusso d'aria continuo da una pompa pneumatica situata nel compressore. La funzionalità è controllata da un'unica via condivisa con il flusso di irrigazione, di cui mantiene la dinamicità di controllo della IOP e facilmente gestibile con un unico rubinetto di selezione di facile ed intuitiva utilizzazione. Il connettore di uscita aria deve essere utilizzato nella modalità segmento posteriore per lo Scambio aria/fluido.
 - Aria filtrata con filtro aria idrofobico da 0,1 micron
 - Pressione aria massima: fino a 150 mmHg (203 cmH2O)
 - Portata: fino a 135 l (4,8 piedi cubi standard)/ora (2,25 l/min)
 - Regolabile da 0 a 150mmHg con incrementi di 1mmHg
 - Timer e avviso sonoro/conferma vocale per modalità Tamponamento

Si esprime per tanto un giudizio ottimo

8. In riferimento al punto 8 "Sistemi di controllo e sicurezza"

- ✓ la ditta TECMED propone
 - B+L si impegna a fornire, prima, durante o dopo l'installazione, tutte quelle prove o misure, previste dalle vigenti disposizioni, atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza di ciascuna apparecchiatura.



- L'installazione delle apparecchiature si intenderà eseguita quando tutte le prove di funzionamento e di rispondenza alle normative vigenti avranno dato esito positivo.

Si esprime per tanto un giudizio sufficiente

9. In riferimento al punto 9 "Sistemi di comando da parte del chirurgo"

- ✓ la ditta TECMED propone
 - Pedale multifunzione wireless con doppio controllo lineare e comando laser integrato:
 - Dimensioni massime: altezza 12,22 cm (4,81"), larghezza: 27,6 cm (10,87"), lunghezza: 32,4 cm (12,75")
 - Peso: 2,7 kg
 - Batteria Li-ion (litio ionico) 3,6 V
 - Componenti esterni e scocca resistenti alla corrosione
 - Scocca a tenuta d'acqua
 - Controllo wireless (raggio standard 10 m)
 - Possibilità di collegamento di emergenza via cavo a bassa tensione
 - Base antiscivolo
 - 4 interruttori funzione
 - Pulsante Laser con sportello di protezione


Si esprime per tanto un giudizio ottimo

10. In riferimento al punto 10 "Personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante (presentare documentazione attestante il possesso di tale requisito preferenziale)"

- ✓ la ditta TECMED propone assistenza fornita entro 24 ore da personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante

Si esprime per tanto un giudizio ottimo

11. In riferimento al punto 11 "Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 24 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio: Se EAFR < 12 mesi, Pi=0; Se 12 ≤ EAFR < 24 mesi, Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;"

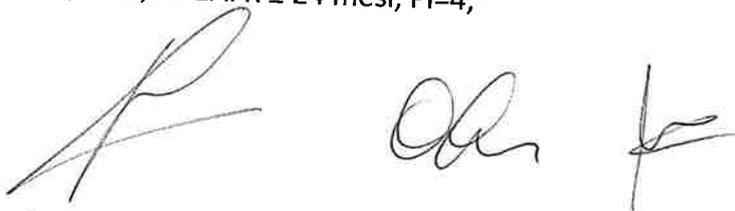

La ditta TECMED offre una garanzia pari al minimo previsto dalla lex specialis di gara pari a n. 24 mesi

Il Presidente della Commissione Dr. Massimo Notaro

Massimo Notaro

Il componente Dr.ssa Ida Cesarano

Ida Cesarano

Il componente Dr.ssa Agnese Santarpia

Agnese Santarpia

LOTTO 01

		Tecmed	Medinova
Monitor (dimensioni, risoluzione, movimentazioni, sensore luce ambiente, etc)	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	4,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	4,00	3,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00	7,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,70
Caratteristiche facoframmentazione (es. frequenza manipolo, etc)			

	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,00	7,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,00	7,00
Caratteristiche vitrectomia (velocità, tipo vitrectomo, modalità di funzionamento)	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,50	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,50	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,50	9,00
Endoilluminazione (caratteristiche sorgenti, regolazione luminosità etc)	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	3,50	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,60

	Punti qualità attribuiti Commissario 2	3,50	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	3,50	3,00
Modulo diatermia	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	8,00	7,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	8,00	7,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	8,00	7,00
Modulo pompa	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	9,00	6,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	9,00	6,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	9,00	6,00
Modulo fluidi e scambio aria fluidi	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60

	Punti qualità attribuiti commissario1	4,50	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	4,50	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	4,50	3,00
Sistemi di controllo e sicurezza	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,00	3,00
Sistemi di comando da parte del chirurgo	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	7,20	4,80
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	7,20	4,80
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	7,20	4,80

<p>Personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante (presentare documentazione attestante il possesso di tale requisito preferenziale)</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>3,00</p>	<p>3,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>0,90</p>	<p>0,90</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario1</p>	<p>2,70</p>	<p>2,70</p>
	<p>Giudizio Commissario 2</p>	<p>0,90</p>	<p>0,90</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario2</p>	<p>2,70</p>	<p>2,70</p>
	<p>Giudizio Commissario 3</p>	<p>0,90</p>	<p>0,90</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario3</p>	<p>2,70</p>	<p>2,70</p>

<p>Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 24 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio: Se EAFR < 12 mesi, Pi=0; Se 12 ≤ EAFR < 24 mesi, Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>4,00</p>	<p>4,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario1</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 2</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario2</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 3</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti commissario3</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

LOTTO 01

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Tecmed	Medinova
Punti qualità attribuiti Comm.1	64,40	48,50
Punti qualità attribuiti Comm.2	64,40	48,50
Punti qualità attribuiti Comm.3	64,40	48,50
Media dei punti di qualità attribuiti	64,40	48,50
Punteggio massimo attribuito	64,40	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Tecmed	Medinova
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,75
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Tecmed	Medinova
Punti qualità riparametrizzati	80,00	60,25

Adm

LOTTO 01	
DITTA	
PUNTEGGIO DI QUALITA'	
80	Tecmed
60,2484472	Medinova

LOTTO 01

AGGIUDICATARIA

80% qualità - 20% prezzo

Tecmed

DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA		PREZZO PIU' BASSO		PUNTEGGIO TOTALE
				PREZZO BASE GARA	PREZZO PIU' BASSO			
Tecmed	80	20	119.545,590	150.000,000	119.545,590		100	
Medinova	60,2484472	18,12414031	122.402,000				78,37258752	

NOTE

file cesareus
Acquiere Sanctoris
per il