

Verbale n. 2 del 15.2.2024

Oggetto: Fornitura triennale, in somministrazione, di dispositivi medici per neurochirurgia – lotti deserti – Importo complessivo a base di gara € 373.809,21 oltre Iva – Numero gara SIMOG: 9154407 – CIG 1 di 14 9885073C49, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70% qualità – 30% prezzo) ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo i sub-criteri per l'attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara

L'anno 2024 il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio alle ore 9:20 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma SIAPS, giusta comunicazione alle ditte partecipanti a mezzo SIAPS del 13/02/2024, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con Delibera del Direttore Generale n. 759 del 23.10.2023, che risulta così costituita:

PRESIDENTE: Dott.ssa Paola Caponegro – Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia c/o AORN Santobono Pausilipon;

COMPONENTE: Dr. Pietro Spennato – Dirigente Medico c/o U.O.C. Neurochirurgia Pediatrica AORN Santobono Pausilipon;

COMPONENTE: Dr. Giuseppe Mirone – Dirigente Medico c/o U.O.C. Neurochirurgia Pediatrica AORN Santobono Pausilipon;

SEGRETARIO: Dott.ssa Erica Ferri – Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione di Gara, vista la Delibera del Direttore Generale n. 759 del 23.10.2023, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 21.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale, in somministrazione, di **dispositivi medici per neurochirurgia – lotti deserti**, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70% qualità – 30% prezzo) ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo i sub-criteri per l'attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara per un importo a base di gara di € 373.809,21 oltre Iva, suddivisa in 14 (quattordici) lotti;
- che la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che è stato pubblicato un avviso di chiarimenti prot. AORN n. 18179 del 06.09.2023 e prot. Siaps n. PI-089807-23;
- che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 13.09.2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;
- che hanno presentato offerta nei termini attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i seguenti concorrenti:



Ragione Sociale	Partita IVA	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
F.A.D. S.R.L.	06088781213	11	PI091090-23	11/09/2023 10:57:22
CISATECH S.R.L.	08862241216	10	PI091435-23	11/09/2023 15:47:56
AC. TA. S.R.L.	06117251212	2,4	PI091656-23	12/09/2023 11:16:04
Gi.Mi. Medical srl	02803471206	14	PI091716-23	12/09/2023 12:14:59
Fe.Ma Srl	13110730150	1	PI091829-23	12/09/2023 13:54:27
SCHEARING	04158311219	9	PI091833-23	12/09/2023 14:24:29
MEDIFIX SRL	02658740614	14	PI091834-23	12/09/2023 14:24:59
Tekka	07414410964	14	PI092249-23	13/09/2023 09:51:10
EFFEBI HOSPITAL sas	04757530284	1	PI092269-23	13/09/2023 09:59:58
MT ORTHO S.R.L.	03821920877	14	PI092363-23	13/09/2023 11:26:38
ARS CHIRURGICA SRL	00495451205	1	PI092365-23	13/09/2023 11:27:06
E.M.S. S.r.l.	IT01900221209	10	PI092477-23	13/09/2023 12:19:26

- o che con verbale n. 1 del 1° 12.2023 la Commissione di Gara ha avuto accesso alle buste telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti per le relativa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dei membri della Commissione Tecnica in virtù della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale così come previsto dall'art. 19 del Disciplinare di Gara.

Tanto premesso, si dà atto che è stata definita - nelle riunioni riservate del 23/01/2024 e 31/01/2024- ed approvata la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara, come da schede di valutazione e relazione allegate al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportati ed inseriti nella piattaforma telematica:

Lotto	Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio riparametrato
1	ARS CHIRURGICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////
1	EFFEBI HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////
1	FE.MA.	42	70
////			
2	AC.TA.	42	70
////			
3	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
////			
4	AC.TA	42	70
////			
5	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
////			
6	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
////			
7	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
////			
8	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
////			
9	SCHEARING	56	70
////			
10	CISATECH	42	70
10	E.M.S.	42	70
////			

11	F.A.D.	42	70
////////////////////////////////////			
12	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
////////////////////////////////////			
13	NESSUNA OFFERTA PERVENUTA		
////////////////////////////////////			
14	GI.MI. MEDICAL	42	70
	MEDIFIX	42	70
	TEKKA	42	70
	MT ORTHO	42	70

In prosieguo, la Commissione alle ore 9:45 continua i lavori, in seduta pubblica e telematica, procedendo all'apertura delle offerte economiche presenti sulla piattaforma SIAPS, limitatamente ai prodotti giudicati conformi per ciascuna ditta.

Lotto	Ditta	Punteggio tecnico riparimetrato	Punteggio economico	Punteggio totale	Offerta economica
1	FE.MA.	70	30	100	€ 23.352,00
////////////////////////////////////					
2	AC.TA.	70	30	100	€ 4.027,50
////////////////////////////////////					
4	AC.TA	70	30	100	€ 24.933,6
////////////////////////////////////					
9	SCHEARING	70	30	100	€ 41.310,00
////////////////////////////////////					
10	CISATECH	70	0,58	70,58	€ 35.109,56
10	E.M.S.	70	30	100	€ 14.424,87
////////////////////////////////////					
11	F.A.D.	70	30	100	€ 59.880,00
////////////////////////////////////					
14	GI.MI. MEDICAL	70	15	85	€ 29.400,00
	MEDIFIX	70	9,55	79,55	€ 31.800,00
	TEKKA	70	30	100	€ 22.800,00
	MT ORTHO	70	15,68	85,68	€ 29.100,00

La Commissione propone pertanto l'aggiudicazione alle Ditte prime in graduatoria, che hanno formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'unica offerta valida.

La Commissione infine prende atto dell'anomalia dell'offerta della Ditta Tekka (lotto 14), ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in quanto sia i punti relativi al prezzo, che quelli relativi alla qualità sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara) e della necessità, di avviare il procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa. Viene dato mandato al RUP di richiedere le giustificazioni. La Commissione termina i lavori e chiude la seduta alle ore 10:10.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto

Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE: Dott.ssa Paola Caponegro

COMPONENTE: Dr. Pietro Spennato

COMPONENTE: Dr. Giuseppe Mirone

SEGRETARIO: Dott.ssa Erica Ferri



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Santobono-Pausilipon”
Via Teresa Ravaschieri ,8 -80122- Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

Napoli,

Oggetto: Valutazione Tecnica – Fornitura triennale, in somministrazione, di dispositivi medici per neurochirurgia-lotti deserti, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70%qualità-30% prezzo).

In data 23/01/2024, la commissione tecnica ha provveduto a visionare la documentazione tecnica inerente la gara in oggetto.

In data 31/01/2024, la commissione ha provveduto a compilare - per gli opportuni giudizi - le schede di valutazione in formato excel per le offerte presentate dalle ditte partecipanti:

Lotto 1: Uncino con elastico per trazione del lembo

Ditte partecipanti: ARS CHIRURGICA, EFFEBI HOSPITAL, FEMA

Da documentazione di gara si evince che le ditte:

ARS CHIRURGICA, EFFEBI HOSPITAL offrono un dispositivo non corrispondente alla descrizione del capitolato.

Nello specifico la ditta **ARS CHIRURGICA** presenta *“un sistema di retrazione auto-statico monouso destinato ad essere impiegato in chirurgia open per la divaricazione superficiale”* non specifico per l’uso in Neurochirurgia

La ditta **EFFEBI HOSPITAL** presenta un *“sistema di retrazione autostatica”* non specifico per l’utilizzo in interventi di Neurochirurgia. Si evince chiaramente in scheda tecnica l’uso per i seguenti interventi:

anastomosi LAR/colo-ale, asportazione del tumore transanale, riparazione della fistola anale, proctectomia perianale, sfinteroplastica, procedure di Hirschsprung.

La ditta **FEMA** offre un dispositivo conforme a quanto richiesto

Lotto 2: Set per la coagulazione bipolare endoscopica

Ditte partecipanti: ACTA

La ditta **ACTA** offre un dispositivo conforme a quanto richiesto

Lotto 3: Sonda a palloncino Fogarthy

DESERTO

Lotto 4: Fibroscopio monouso o multiuso per endoscopia alta risoluzione diversi calibri canale di lavoro e lunghezza -attacco luce e telecamera remoti- compatibilità con sistema di telecamera in dotazione

La ditta **ACTA** offre un dispositivo conforme a quanto richiesto

Lotto 5: Introduttore operativo Peel-Away per fibroscopio flessibile orientabile-compatibilità con fibroscopio in dotazione-mandrino interno perforato per fuoriuscita liquor diversi diametri
DESERTO

Lotto 6: Collagene microfibrillare in fogli emostatico attivo riassorbibile in fogli di TNT
DESERTO

Lotto 7: Reti in materiale riassorbibile per ricostruzione calotta cranica di difetti larghi o fratture pluriframmentate complete di viti o rivetti e materiale applicatore.

DESERTO



Lotto 8: **Kit di introduzione percutanea di catetere distale per derivazioni liquorali ventricolo-atriali con introduttore peel-away che permetta il passaggio di catetere distale per derivazioni liquorali all'interno della giugulare interna.**

DESERTO

Lotto 9: **Aspiratori chirurgici monouso per neurochirurgia in acciaio inox malleabile, dotati di punta atraumatica, di manipolo ergonomico con aletta guida con depressione regolabile, del possibile diametro etc.**

Ditte partecipanti: SHEARING

La ditta **SHEARING** offre un dispositivo conforme a quanto richiesto

Lotto 10: **Kit per il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio**

Ditte partecipanti: EMS, CISATECH

Le ditte **EMS, CISATECH** offrono un dispositivo conforme a quanto richiesto

Lotto 11: **Fibra Laser**

Ditte partecipanti: FAD

La ditta **FAD** offre un dispositivo conforme a quanto richiesto

Lotto 12: **Catetere di silicone radiopaco con indicatori di profondità ed almeno due fori di drenaggio per punture di cisti intraventricolari con due mandrini, uno smussato ed uno affilato. Catetere con estremità perforata e mandrino sporgente.**

DESERTO

Lotto 13: **Introduttore Peel-Away monouso per procedure neuroendoscopiche misure varie**

DESERTO

Lotto 14: **Protesi craniche custom made in titanio per cranioplastica per la ricostruzione di difetti cranici, con indicazione di utilizzo nei pazienti pediatrici, sopra i 2 anni di età.**


Ditte partecipanti: TEKKA, GIMI, MEDIFIX, ORTHO

Tutte le ditte offrono un dispositivo conforme a quanto richiesto.

U.O.C. Farmacia
Dott. ssa Paola Caponegro



S.C. Neurochirurgia
Dr. Pietro Spennato

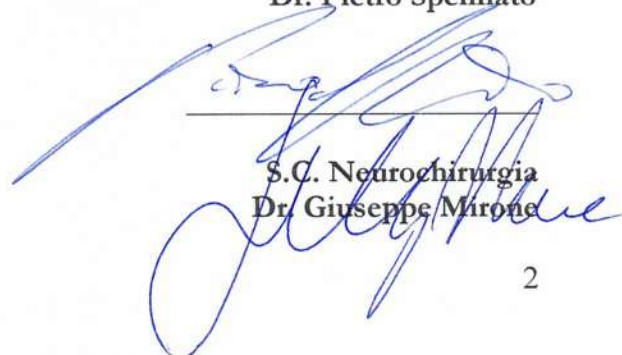

S.C. Neurochirurgia
Dr. Giuseppe Mirone

LOTTO 1				
Uncino con elastico per trazione del lembo		ARS CHIRURGICA	EFFEBI HOSPITAL	FE.MA.
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00	35,00
Buona tenuta nella trazione	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	0,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	0,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	0,00	21,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00	35,00
Resistenza	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	0,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	0,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	0,00	21,00

LOTTO 1

Uncino con elastico per trazione del lembo

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	ARS CHIRURGICA	EFFEBI HOSPITAL	FE.MA.
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	0,00	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00	0,00	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00	0,00	42,00
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00	0,00	42,00
Punteggio massimo attribuito	42,00		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	ARS CHIRURGICA	EFFEBI HOSPITAL	FE.MA.
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00	0,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	ARS CHIRURGICA	EFFEBI HOSPITAL	FE.MA.
Punti qualità riparametrizzati	0,00	0,00	70,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 2

Set per la coagulazione bipolare endoscopica

AC.TA.

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	35,00
Lunghezza	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	35,00
Flessibilità	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00

LOTTO 2

Set per la coagulazione bipolare
endoscopica

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	AC. TA.
Punti qualità attribuiti Comm.1	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	42,00
Media dei punti di qualità attribuiti	42,00
Punteggio massimo attribuito	42,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	AC. TA.
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	AC. TA.
Punti qualità riparametrizzati	70,00

LOTTO 4

Fibroscopio monouso o multiuso per endoscopia alta
risoluzione diversi calibri canale di lavoro e
lunghezza- attacco luce e telecamera remoti -
compatibilità con sistema telecamera in dotazione

AC.TA.

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	35,00
Maneggevolezza	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	15,00
Limitato peso	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Piccole dimensioni	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00

LOTTO 4

Fibroscopio monouso o multiuso per endoscopia alta risoluzione diversi calibri canale di lavoro e lunghezza- attacco luce e telecamera remoti - compatibilità con sistema telecamera in dotazione

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	AC.TA.
Punti qualità attribuiti Comm.1	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	42,00
Media dei punti di qualità attribuiti	42,00
Punteggio massimo attribuito	42,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	AC.TA.
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	AC.TA.
Punti qualità riparametrizzati	70,00

LOTTO 9

Aspiratori chirurgici monuso per neurochirurgia in acciaio inox malleabile, dotati di punta atraumatica, di manipolo ergonomico con aletta guida con depressione regolabile, del possibile diametro di 3-5-7-9-11-12-14-15 Fr e lunghezza cannula di 50-70-90-110-140-180-200-220, completi di mandrino interno

SCHEARING

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	35,00
Malleabilità	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	28,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	28,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	28,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	35,00
Punta atraumatica	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	28,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	28,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	28,00

LOTTO 9

Aspiratori chirurgici monuso per neurochirurgia in acciaio inox malleabile, dotati di punta atraumatica, di manipolo ergonomico con aletta guida con depressione regolabile, del possibile diametro di 3-5-7-9-11-12-14-15 Fr e lunghezza cannula di 50-70-90-110-140-180-200-220, completi di mandrino interno

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SCHEARING
Punti qualità attribuiti Comm.1	56,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	56,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	56,00
Media dei punti di qualità attribuiti	56,00
Punteggio massimo attribuito	56,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SCHEARING
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SCHEARING
Punti qualità riparametrizzati	70,00

LOTTO 10			
Kit per il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio		CISATECH	E.M.S.
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00
Semplicità di applicazione	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	21,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00
Garanzia di tenuta nella posizione	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	21,00

LOTTO 10

Kit per il monitoraggio elettrofisiologico
intraoperatorio

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	CISATECH	E.M.S.
Punti qualità attribuiti Comm.1	42,00	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	42,00	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	42,00	42,00
Media dei punti di qualità attribuiti	42,00	42,00
Punteggio massimo attribuito	42,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	CISATECH	E.M.S.
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	CISATECH	E.M.S.
Punti qualità riparametrizzati	70,00	70,00

LOTTO 11

Fibra Laser

F.A.D.

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	
Fibra ottica pluriuso risterilizzabile	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	
Lunghezza minima 2,5 mt	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	
Utilizzo sorgente laser che eroghi radiazione di 2 u	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	6,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	6,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	
Presenza di connettore tipo F-SMA	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	6,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	6,00

LOTTO 11

Fibra Laser

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	F.A.D.
Punti qualità attribuiti Comm.1	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	42,00
Media dei punti di qualità attribuiti	42,00
Punteggio massimo attribuito	42,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	F.A.D.
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	F.A.D.
Punti qualità riparametrizzati	70,00

LOTTO 14

Protesi craniche custom made in titanio per
 cranioplastica per la ricostruzione di difetti cranici
 con indicazione di utilizzo nei pazienti pediatrici,
 sopra i 2 anni di età. Caratteristiche:
 biocompatibilità e RM compatibili. La realizzazione
 delle protesi deve essere effettuata su misura,
 partendosi dalla TAC del paziente.

		GT MI MEDICAL	MEDIFIX	TEKKA	MT ORTHO
CRITERIO 1	Punti massima attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Indicazione pazienti pediatrici sopra i 2 anni	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,50	0,60	0,50	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00	12,00	12,00
CRITERIO 2	Punti massima attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Biocompatibilità	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00	12,00	12,00
CRITERIO 3	Punti massima attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00
Progettualità personalizzata 3d	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	18,00	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00	18,00	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00	18,00	18,00	18,00

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.

LOTTO 14

Protesi craniche custom made in titanio per cranioplastica per la ricostruzione di difetti cranici, con indicazione di utilizzo nei pazienti pediatrici, sopra i 2 anni di età. Caratteristiche: biocompatibilità e RM compatibili. La realizzazione delle protesi deve essere effettuata su misura, partendosi dalla TAC del paziente.

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	GI. MI. MEDICAL	MEDI-FIX	TERKA	MT ORTHO
Punti qualità attribuiti Comm.1	42,00	42,00	42,00	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	42,00	42,00	42,00	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	42,00	42,00	42,00	42,00
Media dei punti di qualità attribuiti	42,00	42,00	42,00	42,00
Punteggio massimo attribuito	42,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	GI. MI. MEDICAL	MEDI-FIX	TERKA	MT ORTHO
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	1,00	1,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	GI. MI. MEDICAL	MEDI-FIX	TERKA	MT ORTHO
Punti qualità riparametrizzati	70,00	70,00	70,00	70,00

