

Verbale n. 2 del 9.1.2023

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, IN LOTTO UNICO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI COMPRENSIVO DEL COMODATO D'USO DI NR. 85 (OTTANTACINQUE) SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 (DODICI) SISTEMI BLENDER - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 1.245.900,00 OLTRE IVA – (CIG 94572723BE – lotto unico) – Registro Sistema SIAPS n. PI095881-22 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

L'anno 2023 il giorno 9 (nove) del mese di gennaio alle ore 10:30 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma SIAPS, giusta comunicazione di prosieguo dei lavori alle ditte partecipanti a mezzo SIAPS del 4.1.2023 (Registro di Sistema n. PI000702-23), i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con Delibera del Direttore Generale n. 836 del 30.11.2022, che risulta così costituita:

PRESIDENTE: Dr. Paolo Cavaliere – Dirigente Medico UOC Pediatrica d'Urgenza, Pronto Soccorso e Terapia Sub - Intensiva c/o AORN Santobono Pausilipon;


COMPONENTE: Dr. Fabio Antonelli - Dirigente Medico U.O.C. Pneumologia e UTSIR c/o AORN Santobono Pausilipon;

COMPONENTE: Dr.ssa Marialuisa Zagaria – Dirigente Medico U.O.C. Terapia c/o AORN Santobono Pausilipon;

SEGRETARIO: Dott.ssa Erica Ferri – Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

La Commissione di Gara, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 733 del 28.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale di dispositivi medici per il trattamento delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia ad alti flussi comprensivo del comodato d'uso di nr. 85 sistemi integrati e nr. 12 sistemi blender, per un importo a base di gara di € 1.245.900,00 oltre Iva, lotto unico
- che la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che è stato pubblicato un avviso di chiarimenti prot. AORN n. prot. n. 0022421 del 16.11.2022 e prot. Siaps n. PI100421-22;
- che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 25.11.2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;
- che hanno presentato offerta nei termini attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i seguenti concorrenti:

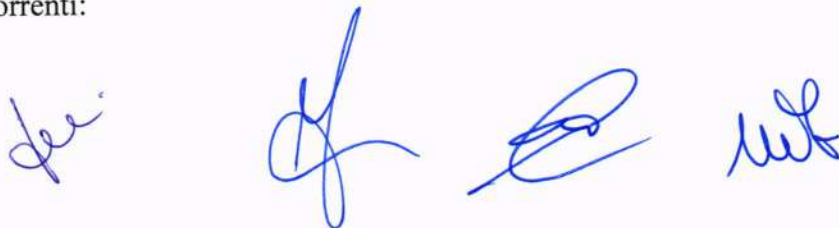

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
SVAS BIOSANA S.p.A.	04720630633	01354901215	PI104929-22	24/11/2022 16:46:23
BURKE & BURKE SpA	02737030151	01059590107	PI105111-22	24/11/2022 17:31:12

Visto il verbale n. 1 del 5.12.2022 dal quale risulta che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare di Gara, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 733 del 28.10.2022, ha inteso avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, procedendo per tutti i concorrenti prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, con le modalità di cui agli art. 21 e 22, e poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, così come previsto dall'art. 23;

Visto che, dal già citato verbale n. 1 del 5.12.2022 della Commissione di Gara, risulta che sono state aperte le buste telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti per le relativa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dei membri della Commissione Tecnica.

Tanto premesso, si dà atto che è stata definita - nella riunione riservata del 3/01/2023- ed approvata la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara - anche all'esito della prova pratica, di cui ai verbali del 13/12/2022 agli atti - come da schede di valutazione allegate al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportati ed inseriti nella piattaforma telematica:

Lotto unico	Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio riparametrato
///////	SVAS BIOSANA S.p.A.	80,00	80,00
///////	BURKE & BURKE SpA	58,50	58,50

In prosieguo, la Commissione provvede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche telematiche, ai calcoli finalizzati all'attribuzione dei punteggi economici riportati nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale, determinando la seguente graduatoria provvisoria:


Lotto	Ditta	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Punteggio totale	Prezzo offerto
1	SVAS BIOSANA S.p.A.	80,00	1,162	81,162	€ 1.238.626,00
2	BURKE & BURKE SpA	58,50	20	78,50	€ 1.120.711,00

La Commissione propone pertanto l'aggiudicazione alla Ditta Svas Biosana prima in graduatoria, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, fatta salva la valutazione della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di gara.

La Commissione termina i lavori e chiude la seduta alle ore 11:00 e rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza.

Del che è verbale, letto, confermato, è sottoscritto

PRESIDENTE: Dr. Paolo Cavaliere
 COMPONENTE: Dr. Fabio Antonelli
 COMPONENTE: Dott.ssa Marialuisa Zagaria
 SEGRETARIO: Dott.ssa Erica Ferri

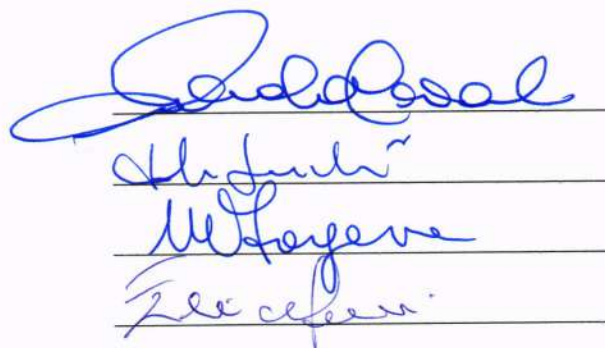

Verbale del 03/01/2023

Oggetto: procedura aperta per la fornitura quinquennale di dispositivi medici per il trattamento delle patologie respiratorie mediante ossigenoterapia ad alti flussi comprensivo del comodato d'uso di n. 85 sistemi integrati e n.12 sistemi blender

In data odierna si riunisce la Commissione Tecnica di gara composta dal dott. P. Cavaliere (Presidente), dott. F. Antonelli (Componente) e dalla dott.ssa M. Zagaria (Componente) alle ore 12.10 per la formulazione del giudizio tecnico.

In merito al Criterio 1 per l'attribuzione dei punteggi di qualità la Commissione reputa le caratteristiche dei sistemi integrati ad alti flussi egualmente performanti ad eccezione di:

- regolazione di flussi della Burke & Burke su "impostazione alti flussi e bassi flussi" crea confusione dell'operatore nei momenti di urgenza/emergenza in quanto la definizione di terapia ad alto flusso o basso flusso in età neonatale e pediatrica si basa sul peso del paziente e non su valori predefiniti (come avviene nell'adulto);
- il sistema di disinfezione integrata della Svas Biosana appare più ergonomico e maneggevole in quanto non dotato di unità esterna che invece è previsto nella disinfezione degli apparecchi della Burke & Burke.

In merito al Criterio 2 per l'attribuzione dei punteggi di qualità la Commissione reputa:

- La forma troncoconica e la consistenza delle nasocannule offerte dalla Ditta Svas Biosana garantiscono una maggiore vestibilità ed una più rara fuoriuscita della cannula dalle narici del paziente, garantendo una costante erogazione di ossigeno. Viceversa la consistenza della cannule Burke & Burke e la loro forma tradizionale si presta a frequenti dislocazioni delle stesse con sospensione e rischiosa interruzione dell'ossigenoterapia.
- Il tubicino di connessione alle cannule offerta dalla Ditta Svas Biosana è costituito in acciaio inossidabile e mantiene costante il calore del gas durante l'erogazione evitando il collasso del circuito in caso di schiacciamento. Tali caratteristiche non sono presenti nelle cannule Burke & Burke che sono suscettibili a frequenti torsioni che dislocano le naso cannule dalle narici del paziente.
- I cuscinetti di fissaggio delle nasocannule offerti dalla ditta Svas Biosana integrati con cerottino idrocolloidale anallergico garantiscono una buona adesività anche in presenza di secrezioni ed ipersalivazione. Al contrario il sistema di fissaggio offerto dalla Burke & Burke non garantisce buona adesività favorendo la dislocazione delle nasocannule dalle narici del paziente nonostante il cerotto offerto in aggiunta.
- Maggiore gamma di misure della ditta Svas Biosana. Infatti le nasocannule della suddetta azienda presentano 4 misure pediatriche , facilmente identificabile per codice colore. Le cannule della ditta Burke & Burke hanno solo tre misure pediatriche.

Alla luce di tali considerazione le naso cannule offerte dalla ditta Svas Biosana appaiono nettamente superiori a quelle offerte dalla ditta Burke & Burke.

In merito al Criterio 3 per l'attribuzione dei punteggi di qualità la Commissione reputa le caratteristiche per sistemi blender egualmente performanti e rispondenti al capitolato.

Napoli, 03/01/2023

Il Presidente dott. Paolo Cavaliere

firmato



Componente dott. Fabio Antonelli

firmato



Componente dott.ssa Marialuisa Zagaria

firmato




LOTTO UNICO			
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, IN LOTTO UNICO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI COMPRENSIVO DEL COMODATO D'USO DI NR. 85 (OTTANTACINQUE) SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 (DODICI) SISTEMI BLENDER - Importo complessivo a base di gara € 1.245.900,00 oltre Iva - CIG 94572723BE		SVAS BIOSANA	BURKE & BURKE
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
Caratteristiche dei sistemi integrati di ossigenoterapia ad alti flussi (regolazione flussi, display, allarmi, modalità di funzionamento, contenimento della condensa, disinfezione) - valutazione su prova pratica	Giudizio Commissario 1	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	13,50
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	13,50
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	13,50
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	50,00	50,00
Caratteristiche delle interfacce e sistemi di fissaggio (dimensioni, ergonomia, contenimento condensa, presenza di raccordi per collegamento all'apparecchiatura, ecc) - valutazione su prova pratica	Giudizio Commissario 1	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	50,00	30,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	50,00	30,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	50,00	30,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
Caratteristiche per sistemi blender (tipologie, flussimetri ed umidificatori proposti, contenimento condensa, regolazione flussi, allarmi, modalità di funzionamento, usabilità) - valutazione su prova pratica	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	15,00

LOTTO UNICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, IN
SOMMINISTRAZIONE,
IN LOTTO UNICO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO
DELLE PATOLOGIE
RESPIRATORIE MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI
COMPENSIVO DEL
COMODATO D'USO DI NR. 85 (OTTANTACINQUE) SISTEMI INTEGRATI E
NR. 12 (DODICI)
SISTEMI BLENDER - Importo complessivo a base di gara €
1.245.900,00 oltre Iva - CIG 94572723BE

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SVAS BIOSANA	BURKE & BURKE
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00	58,50
Punti qualità attribuiti Comm.2	80,00	58,50
Punti qualità attribuiti Comm.3	80,00	58,50
Media dei punti di qualità attribuiti	80,00	58,50
Punteggio massimo attribuito	80,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SVAS BIOSANA	BURKE & BURKE
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,73
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SVAS BIOSANA	BURKE & BURKE
Punti qualità riparametrizzati	80,00	58,50

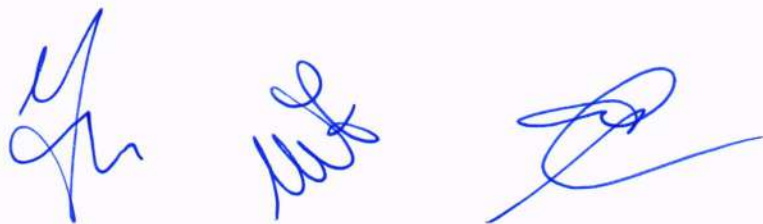

[illegible]Three handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The top signature is a stylized 'A' with a horizontal bar. The middle signature is a cursive 'M' with a horizontal bar. The bottom signature is a cursive 'E' with a horizontal bar.

pen

LOTTO UNICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE,
IN LOTTO UNICO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE
RESPIRATORIE MEDIANTE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI COMPRENSIVO DEL
COMODATO D'USO DI NR. 85 (OTTANTACINQUE) SISTEMI INTEGRATI E NR. 12 (DODICI)
SISTEMI BLENDER - Importo complessivo a base di gara € 1.245.900,00 oltre Iva - CIG 94572723BE

AGGIUDICATARIA

80% qualità - 20% prezzo

SVAS BIOSANA

[illegible]

NOTE

K

